

# ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS

## COTAÇÃO DE PREÇO Nº 12/2017

### Associação Educacional e Caritativa - Hospital Regional São Paulo

Em 30 de novembro, os integrantes da Equipe de Apoio reuniram-se para a realização da Cotação de Preço definida pelo Edital de Cotação nº 12/2017 – Convênio nº 835042/2016, para aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde, após esgotado o prazo para encaminhamento das propostas pelas empresas interessadas, procederam a avaliação dos documentos apresentados e do Relatório Técnico nº 075/2017, em anexo, fornecido pelo engenheiro clínico responsável, obedecendo o item “6.3.1. Serão analisadas as 02 (duas) primeiras propostas de menor valor, caso não se conclua a compra, serão analisadas as propostas subsequentes de menor valor”, concluindo que:

#### I – Mapa das propostas recebidas:

Item	Objeto	Qtd.	Valor Un. TR	Valor Total TR	Alfa Med	DC	Deltronix	Instramed	Leistung	Magnamed	Medcir	Philips
1.1	Cardioversor Bifásico com DEA	1	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00		R\$ 12.356,00		R\$ 16.000,00				R\$ 18.888,00
1.2	Mamógrafo Digital	1	R\$ 630.100,00	R\$ 630.100,00								R\$ 625.000,00
1.3	Monitor multiparamétrico	8	R\$ 20.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 14.800,00							R\$ 17.220,00
1.4	Bisturi Elétrico (a partir de 200 W)	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00			R\$ 18.648,68				R\$ 13.763,00	
1.5	Ventilador Pulmonar	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00					R\$ 14.300,00	R\$ 29.000,00		

Item	Objeto	Qtd.	Valor Un. TR	Valor Total TR	Prolife	RTC	Samtronic	SC Medical	Sul Imagem	Transmai	W&Z	WEM
1.1	Cardioversor Bifásico com DEA	1	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00							19.000,00	
1.2	Mamógrafo Digital	1	R\$ 630.100,00	R\$ 630.100,00					625.000,00			
1.3	Monitor multiparamétrico	8	R\$ 20.000,00	R\$ 160.000,00	13.400,00	20.000,00	14.000,00	11.950,00		8.160,00		
1.4	Bisturi Elétrico (a partir de 200 W)	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00								17.800,00
1.5	Ventilador Pulmonar	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00				10.560,00				

#### IV - Em relação às exigências editalícias, foram desclassificadas:

##### Item 1.1 – Cardioversor Bifásico com DEA. Quantidade: 01 unidade.

**Empresa:** DC Heart Desfibriladores e Sistemas Médicos LTDA. CNPJ: 13.676.954/0001-60.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita unidade relativa de operação entre 30 e 90% e o produto cotado apresenta de 30 a 75%.

##### Item 1.2 – Mamógrafo Digital. Quantidade: 01 unidade.

**Empresa:** Philips Medical Systems LTDA. – CNPJ: 58.295.213/0021-11.

Justificativa: Empresa esta desclassificada, pois não encaminhou o Atestado de Capacidade Técnica com o CNPJ vinculado a proposta.

**Empresa:** Sul Imagem Produtos para Diagnósticos EIRELI. CNPJ: 03.135.637/0001-83.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita velocidade de rotação do anodo de 10.000 rpm e na proposta consta 9500 rpm. Edital solicita faixa de mAs de 1,1 a 560 e na proposta consta 3 a 500 mAs.

**Item 1.3 - Monitor Multiparamétrico. Quantidade: 08 unidades.**

**Empresa:** Transmai Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA. CNPJ: 43.179.225/0001-60.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. Edital solicita proteção IPX1 e segundo o manual da ANVISA o produto cotado apresenta IPX0.

Justificativa: Empresa não atendeu ao item 5 do edital. 5.1 e 5.2 letra h. Conforme previsto em edital. 6.4 - Serão desclassificadas as propostas que: a) não atenderem às exigências deste edital.

**Item 1.5 - Ventilador Pulmonar. Quantidade: 01 unidade.**

**Empresa:** SC Medical Comércio e Serviço EIRELI – ME. CNPJ: 12.246.862/0001-88.

Parecer Técnico: Em desacordo com o edital. No edital solicita frequência respiratória de 5 a 50 rpm e o modelo cotado apresenta 1 a 30 rpm. Edital solicita percentagem de O2 de 40 a 100% e na proposta consta de 50 a 100%.

**Empresa:** Leistung Equipamentos LTDA. CNPJ: 04.187.384/0001-54.

Parecer Técnico: Em desacordo com edital. Edital solicita percentagem de O2 de 40 a 100% e na proposta consta 50 ou 100%.

**V- Em relação às empresas classificadas, por item e ordem de classificação:**

**Item 1.1 – Cardioversor Bifásico com DEA. Quantidade: 01 unidade.**

**1º Empresa:** Instramed Indústria Médico Hospitalar LTDA. - CNPJ: 90.909.631/0001-10.

Valor de R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a unidade. Total: R\$ 16.000,00.

**2º Empresa:** Philips Medical Systems LTDA. – CNPJ: 58.295.213/0021-11.

Valor de R\$ 18.888,00 (dezoito mil oitocentos e oitenta e oito reais) a unidade. Total: R\$18.888,00.

**Item 1.3 - Monitor Multiparamétrico. Quantidade: 08 unidades.**

**1º Empresa:** SC Medical Comércio e Serviço EIRELI – ME. - CNPJ: 12.246.862/0001-88.

Valor de R\$ 11.950,00 (onze mil e novecentos e cinquenta reais) a unidade. Total: R\$ 95.600,00.

**2º Empresa:** Prolife Equipamentos Médicos EIRELI. - CNPJ: 66.783.630/0002-79.

Valor de R\$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais) a unidade. Total: R\$ 107.200,00.



**Item 1.4 – Bisturi Elétrico (a partir de 200 W). Quantidade: 01 unidade.**

**1º Empresa:** Medical Cirúrgica LTDA – EPP (Medcir). – CNPJ: 60.683.786/0001-10.

Valor de R\$ 13.763,00 (treze mil setecentos e sessenta e três reais) a unidade. Total: R\$ 13.763,00.

**2º Empresa:** WEM Equipamentos Eletrônicos LTDA. CNPJ: 54.611.678/0001-30.

Valor de R\$ 17.800,00 (dezesete mil e oitocentos reais) a unidade. Total: R\$ 17.800,00.

**Item 1.5 - Ventilador Pulmonar. Quantidade: 01 unidade.**

**1º Empresa:** Magnamed Tecnologia Médica S/A. CNPJ: 01.298.443/0002-54.

Valor de R\$ 29.000,00 (vinte nove mil reais) a unidade. Total: R\$ 29.000,00.


Nada mais havendo, a presente Ata vai rubricada e assinada pela Diretora Geral da entidade e pelos demais integrantes da equipe de apoio, abaixo identificados, devendo ser divulgada, encaminhado por meio eletrônico às empresas participantes, e disponibilizada em seu sítio oficial.

Xanxerê, 30 de novembro de 2017.




Neusa Lucio Luiz

Diretora Geral da Associação Educacional e Caritativa – Hospital Regional São Paulo

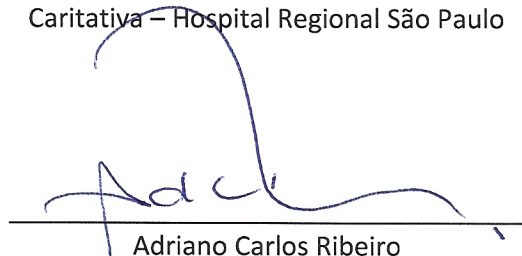

Adriano Carlos Ribeiro

Instituto Santé

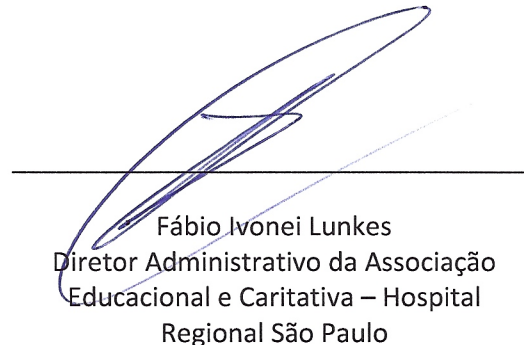

Fábio Ivonei Lunkes  
Diretor Administrativo da Associação Educacional e Caritativa – Hospital Regional São Paulo



Erlon de Rocco

Technocare Engenharia Clínica



Patrícia Teixeira Vieira  
Instituto Santé